




Cleaning Technology

UPC 3000

CONTRÔLEUR DE PROCESSUS À ULTRASONS

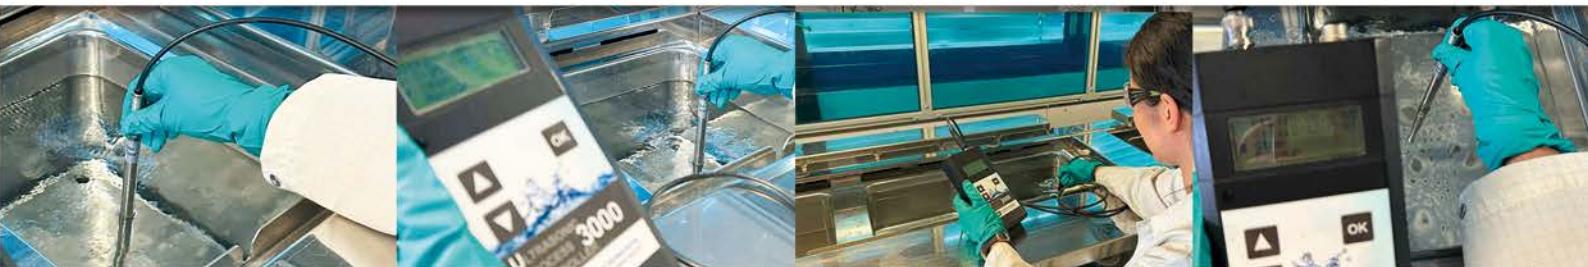

ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

SWISS QUALITY

ÉQUIPEMENT UPC 3000 : CONTRÔLEUR DE PROCESSUS À ULTRASONS POUR VOS LIGNES DE LAVAGE

LISTE DE CONTRÔLE DU PROCESSUS DE NETTOYAGE AVEC NOTRE UPC3000

Le processus de nettoyage est basé sur une combinaison de plusieurs paramètres. Avant d'envisager le remplacement de la chimie, NGL recommande de vérifier ces autres paramètres principaux :

- Qualité de l'eau de rinçage
- Action mécanique des ultrasons
- Température de la solution de nettoyage
- Dosage de la solution de nettoyage



CONTRÔLE RAPIDE ET SIMPLE DE VOTRE LIGNE DE NETTOYAGE PAR ULTRASONS

L'UPC 3000 est livré avec 3 sondes, pour une mesure instantanée et facile des principaux paramètres de nettoyage. Les opérateurs peuvent effectuer une surveillance directe et corriger les écarts de paramètres ou identifier les dysfonctionnements critiques.

Malette de rangement



Livré avec 4 piles NiMH rechargeables 1,2V AA 2100 mAh. Ne pas utiliser de piles AAA.

! NE PAS IMMERGER LES SONDES DANS L'EAU LORSQUE L'APPAREIL EST BRANCHÉ SUR UNE PRISE ÉLECTRIQUE !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mesure de la température	Domaine de mesure entre 0 et 99.9 °C (+/- 0.2°C)
Mesure de la conductivité et de la concentration des bains de lessive	Domaine de mesures : 1 µS/cm à 2 S/cm Affichage en % de la concentration (+/-0,1 % de la valeur mesurée)
Mesure de la conductivité de l'EDI	Domaine de mesures : 0,001 µS/cm à 200 µS/cm Affichage en µS/cm de la conductivité (+/-0,1 % de la valeur mesurée)
Mesure de la puissance ultrasonique	Domaine de mesure : 0 à 40 Watt/L Affichage en Watt/L (+/- 5 unités)

NGL VOUS ACCOMPAGNE

- Des démonstrations sur place peuvent être organisées
- La formation est incluse dans l'achat d'une unité
- Jusqu'à 9 produits (uniquement NGL) peuvent être configurés dans l'UPC
- Un recalibrage annuel est recommandé pour une fiabilité maximale
- 1 an de garantie



Seule une gamme de produits NGL peut être mise en place dans notre unité UPC 3000

LIGNES DIRECTRICES DES PARAMÈTRES

Rinçage final = eau DI	Conductivité = 0,1 à 1µS Couleur : limpide. Température : ambiante (au delà de 55°C les membranes de filtration peuvent être endommagées)
Rinçage à l'eau du robinet	Couleur : limpide. Température : ambiante
Action mécanique	Vérifier la puissance en 5 points différents du réservoir. Interprétation des résultats moyens : - Inférieur à 10 Watts/L : envisager un entretien ou un remplacement - Entre 10 et 20 Watts/L : acceptable - Supérieure à 20 Watts/L : bonne
Température	Excessif = séchage instantané des produits chimiques sur les pièces Trop bas = actions mécaniques et chimiques réduites 60 à 70°C = nettoyage plus rapide + cavitation plus importante des ultrasons
Concentration en chimie	Excessif = report + contamination. Trop faible = épuisement de la solution + efficacité réduite Recommandations relatives à la concentration de NGL : 3-5 % pour le nettoyage, 1-2 % pour la finition

NOS FILIALES À TRAVERS LE MONDE

NGL FRANCE SAS

Parc Akitiland Bât B
1 rue de Lombardie
FR-69800 SAINT-PRIEST
france@ngl-group.com

NGL SHANGHAI

Room 407, Building 3, No.3199 Jinhai Road
Fengxian District
CN-201406 SHANGHAI
shanghai@ngl-group.com

NGL CLEANING GMBH

Schlavenhorst 15
DE-46395 BOCHOLT
kontakt@ngl-group.com

NGL ASIA PACIFIC PTE LTD

28 Kallang Place #05-09
Kallang Basin Industrial Estate
SG-339158 SINGAPOUR
asiapacific@ngl-group.com


NGL NORDIC A/S

Industriskellet 10
DK-2635 ISHØJ
nordic@ngl-group.com

NGL AMERICA INC.

747 North Church Road, Suite G-9
ELMHURST, IL 60126, USA
usa@ngl-group.com

06/05/2025

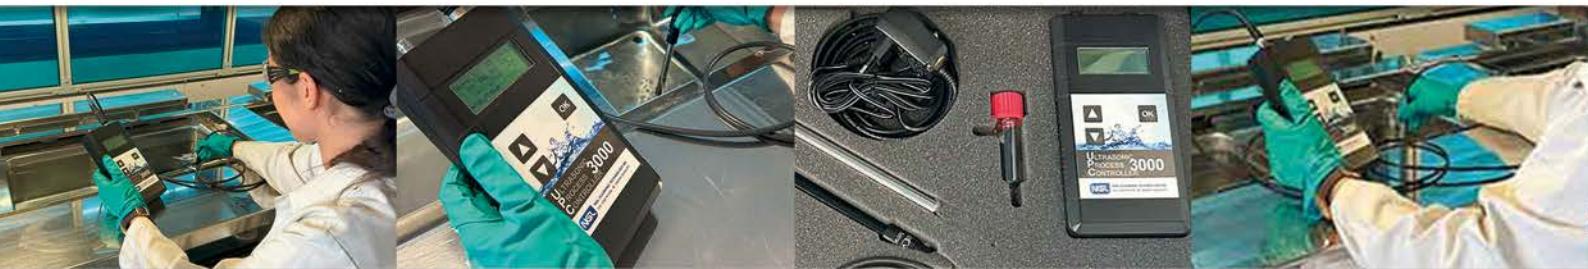

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com



SWISS
QUALITY

